

Acta: Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las 12:30 (doce horas con treinta minutos) del día miércoles 15 (quince) de noviembre de 2023 (dos mil veintitrés), se reunieron en la sala de juntas de la División de Investigación, Desarrollo e Innovación del 4to piso del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante y el licitante, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** de la Licitación Pública Nacional **UAEH-LP-N71-2023**, para el **Equipamiento a clínicas odontológicas segundo procedimiento**, misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Una vez integrado el registro de participantes, la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, encontrándose presente el siguiente licitante:

1. **MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V.** representada en este acto por el C. Oscar Redonda Borja.

Observadores:

- C. Jessica Hevia Hoyo.
- C. Ma. de Lourdes Muñozcano Rojas.

Aclaraciones Administrativas:

A) Por la convocante:

- La factura se realizará conforme a la orden de compra/servicio, incluyendo número de orden de compra/servicio.
- Se requiere padrón de proveedores de Gobierno del Estado vigente, para la presentación de proposiciones y este se otorga a través de la Dirección General de Normatividad de Gobierno del Estado de Hidalgo.


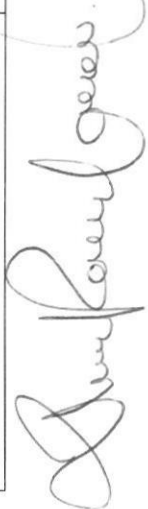
B) Por la concursante:

- MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V. presenta sus siguientes dudas Administrativas:

Pregunta:	Respuesta:
1.-REFERENCIA: DOCUMENTO II. ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL; TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 2.3.3. Documentación que integra la proposición del licitante de las bases de la presente licitación

45C

Acta: Junta de Aclaraciones

<p>CONSTITUTIVA, REFORMAS O MODIFICACIONES (EL ORIGINAL SOLO SERÁ PARA COTEJO).</p> <p>PREGUNTA: CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTAMINACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE, REDUCIENDO EL NÚMERO DE HOJAS IMPRESAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y SU ÚLTIMA REFORMA, Y DE RESULTAR ADJUDICADOS, AL FORMALIZAR EL CONTRATO SE PRESENTARAN TODAS LAS REFORMAS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>2.- REFIRIÉNDONOS AL PUNTO "1.3. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA"</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SEA DE 120 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, YA QUE LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS SON PROVENIENTES DE ISRAEL, Y COMO ES DE CONOCIMIENTO GENERAL DICHO PAÍS SE ENCUENTRA EN UN CONFLICTO QUE, SI BIEN NO AFECTA A LA PLANTA DE FABRICACIÓN, LOS VUELOS Y EXPORTACIONES SI SE VEN AFECTADOS EN TIEMPO, POR LO QUE APELAMOS A SU COMPRESIÓN Y CONSIDERE NUESTRA PETICIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 1.3 plazo y condiciones de entrega de las bases de la presente licitación.</p> 

Aclaraciones Técnicas

1. Por la convocante:


La convocante manifiesta no tener aclaraciones técnicas.

2. Por la concursante:

- MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V. presenta sus siguientes dudas Técnicas:

Pregunta:	Respuesta:
<p>Referente a la partida 6:</p> <p>LAMPARA DE FOTOCURADO: CON ESPECTRO DE BANDA ANCHA, RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 385-515 NM SEGÚN ISO 10650. FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNACIONAL DE GRADO MÉDIC ADECUADO PARA TOMAS DE CORRIENTE DE 100 A 240 VOLTIOS. COMPONENTES DEL PRODUCTO:</p> <p>• 1 – LÁMPARA DE FOTOCURADO CON CABLE CON CABLE DE 7 PIES/2.1 METROS</p>	<p>No se acepta su propuesta, al no cumplir con la longitud de onda solicitada en el anexo técnico.</p>

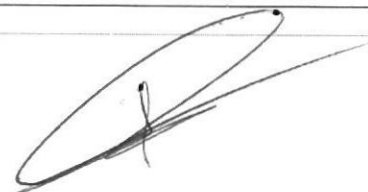



45E


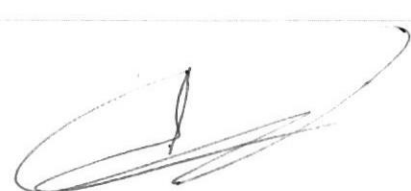
Acta: Junta de Aclaraciones

<p>MESA PASTEUR CON CAJON DE ACERO INOXIDABLE FABRICADO CUBIERTA Y ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL. 20 TIPO 304, BARANDAL DE ALAMBRON DE 3/8" DE ACERO INOXIDABLE, CAJON CON JALADERAS EMBALADAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" EN CAL. 18 ACABADO PULIDO, LLANTA DE 3" COLOR NEGRO MEDIDAS: 60 X 40 X 100CMS</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>Referente a la partida 10:</p> <p>MESA DE MAYO CON CHAROLA: 4 RUEDAS GIRATORIAS DE 2 PULGADAS. BANDEJA REMOVIBLE DE ACERO INOXIDABLE. BANDEJA CON MEDIDAS DE 47CM DE LARGO POR 36CM DE ANCHO. ESTRUCTURA RESISTENTE Y LIGERA PARA SU FÁCIL TRASLADO. ALTURA AJUSTABLE: MÁXIMA DE 117 CENTÍMETROS Y MÍNIMA DE 77 CENTÍMETROS.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR LO SIGUIENTE;</p> <p>MESA MAYO DE ACERO INOXIDABLE FABRICADO ARO PORTA CHAROLA CON SOLERA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL 16 TIPO 304, INCLUYE CHAROLA MAYO EN CAL 22 DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ,ESTRUCTURA DE PERFIL CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2" EN CAL 18 , COLUMNA FIJA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4" Y COLUMNA DESLIZABLE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" EN CALIBRE 18 ACABADO PULIDO , PERILLA OPRESORA DE PLASTICO PARA DAR DIFERENTES MOVIMIENTOS EN COLOR NEGRO, 4 RODAJA TIPO BOLA DE HULE DE 2" EN COLOR NEGRO MEDIDAS 35X60X90 A 150cm</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se acepta su propuesta.</p>
<p>Referente a la partida 17:</p> <p>BANCO DE LABORATORIO METALICO: DE ACERO INOXIDABLE, ASIENTO DE DIÁMETRO DE 14", CAPACIDAD EN LIBRAS DE 250, ALTURA AJUSTABLE DE 25-30", PESO EN LIBRAS 12</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR LO SIGUIENTE;</p> <p>BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE. ASIENTO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL 18, REFUERZO EN EL ASIENTO EN FORMA DE CRUZ CON SOLERA, TUERCA PARA RECIBIR EL ESPARRAGO ACABADO GALVANIZADO PARA LA ALTURA VARIABLE. ESTRUCTURA DE</p>	<p>Se acepta su propuesta.</p>

45E

Acta: Junta de Aclaraciones
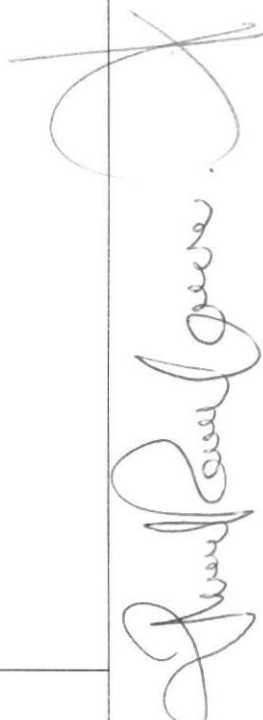
<p>• 1 – ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 9 VOLTIOS, DE GRADO MÉDICO E INTERNACIONAL CON CABLE DE 6 PIES/1.8 METROS Y CONECTORES UNIVERSALES</p> <p>• 1 - PAQUETE DE MUESTRA DE FUNDAS DE BARRERA</p> <p>• 1 - GAFAS DE SEGURIDAD DE COLOR ÁMBAR</p> <p>• 1 - SOPORTE DE MONTAJE DE SUPERFICIE PARA LA LÁMPARA DE FOTOCURADO CON CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR LO SIGUIENTE;</p> <p>LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN LED ALÁMBRICA CON UNA INTENSIDAD DE 800MW/CM2. PARA FOTO CURAR EN LOS RANGOS DE LONGITUD DE ONDA DE 390 – 490 NM FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNACIONAL DE GRADO MÉDICO ADECUADO PARA TOMAS DE CORRIENTE DE 100 A 240 VOLTIOS.</p> <p>COMPONENTES DEL PRODUCTO:</p> <p>• 1 – LÁMPARA DE FOTOCURADO CON CABLE CON CABLE DE 7 PIES/2.1 METROS</p> <p>• 1 – ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 9 VOLTIOS, DE GRADO MÉDICO E INTERNACIONAL CON CABLE DE 6 PIES/1.8 METROS Y CONECTORES UNIVERSALES</p> <p>• 1 – PAQUETE DE MUESTRA DE FUNDAS DE BARRERA</p> <p>• 1 – GAFAS DE SEGURIDAD DE COLOR ÁMBAR</p> <p>• 1 – SOPORTE DE MONTAJE DE SUPERFICIE PARA LA LÁMPARA DE FOTOCURADO CON CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>Referente a la partida 9:</p> <p>MESA TIPO PASTEUR CON CAJÓN. CUBIERTA Y ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 PULIDA P3 CON ESPESOR DE 0.9 MM.</p> <p>BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 PULIDO P3 CON ESPESOR 1.5MM.</p> <p>ESTRUCTURA EN PERFIL DE ACERO Ø 25MM CON ESPESOR 1.2 MM, ACABADO CROMO.</p> <p>CUATRO RODAJAS DE HULE TERMO-PLÁSTICO DE Ø 51 MM. MEDIDAS Y PESO:</p> <p>ANCHO:39CM LARGO:62CM ALTURA TOTAL:90CM PESO:8.85KG</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR LO SIGUIENTE;</p>	<p>Se acepta su propuesta.</p> 



Acta: Junta de Aclaraciones


TUBO DE 1" Y DESCANSA PIES DE TUBO DE 1/2" DE ACERO INOXIDABLE, CON REGATON FIJO DE PLASTICO COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO. MEDIDAS 30 DIAM X 55 A 65 CM

¿SE ACEPTA?

Quedan debidamente notificados, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo el día viernes 17 (diecisiete) de noviembre de 2023 (dos mil veintitrés) a las 16:30 (dieciséis horas con treinta minutos) en el auditorio de primer piso del edificio Torres de rectoría.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 13:15 (trece horas con quince minutos) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.


Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

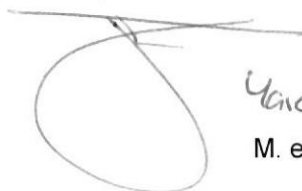


Yarely Sánchez Escamilla
M. en C. Julio César Leines Medécigo
Presidente
L.H.M. Yarely Sánchez Escamilla
Representante




Mtra. Maricela Escárcega Ramírez
Secretaria
L.A. Dulce Rodríguez Gutiérrez
Representante

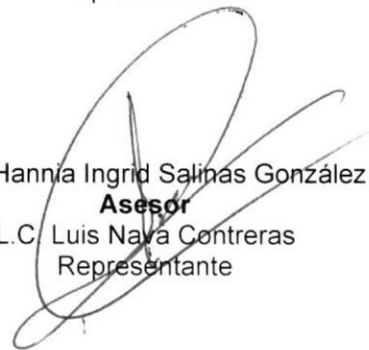

Mtra. Hannia Ingrid Salinas González
Asesor
L.C. Luis Nava Contreras
Representante



Mtro. Antonio Mota Rojas
Asesor
Lic. Mariana Figueroa Santillán
Representante

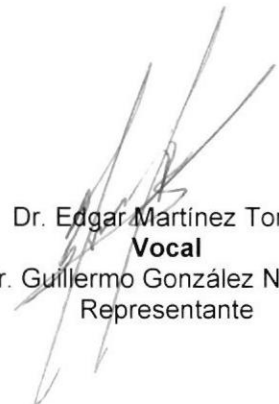

Dr. Edgar Martínez Torres
Vocal
Dr. Guillermo González Naranjo
Representante

Acta: Junta de Aclaraciones

Asesor Técnico

Dr. José de Jesús Navarrete Hernández
Jefe del Área Académica de Odontología

Licitante:

C. Oscar Redonda Borja
Representante
MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.

